


MARGE DE 1CM À RAJOUTER SUR CE CÔTÉ ↓




YEUX

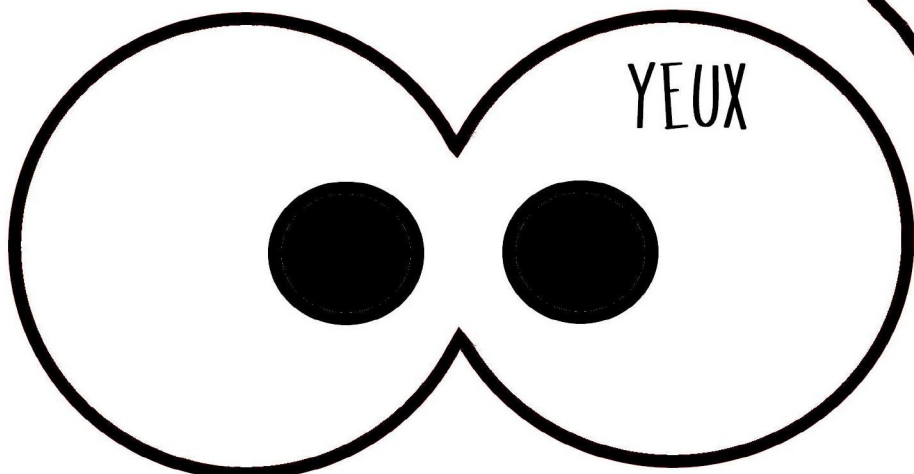


AILE

X2 TISSU EXTÉRIEUR
X2 DOUBLURE

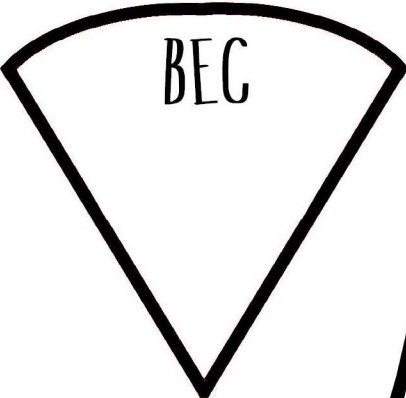

BEC

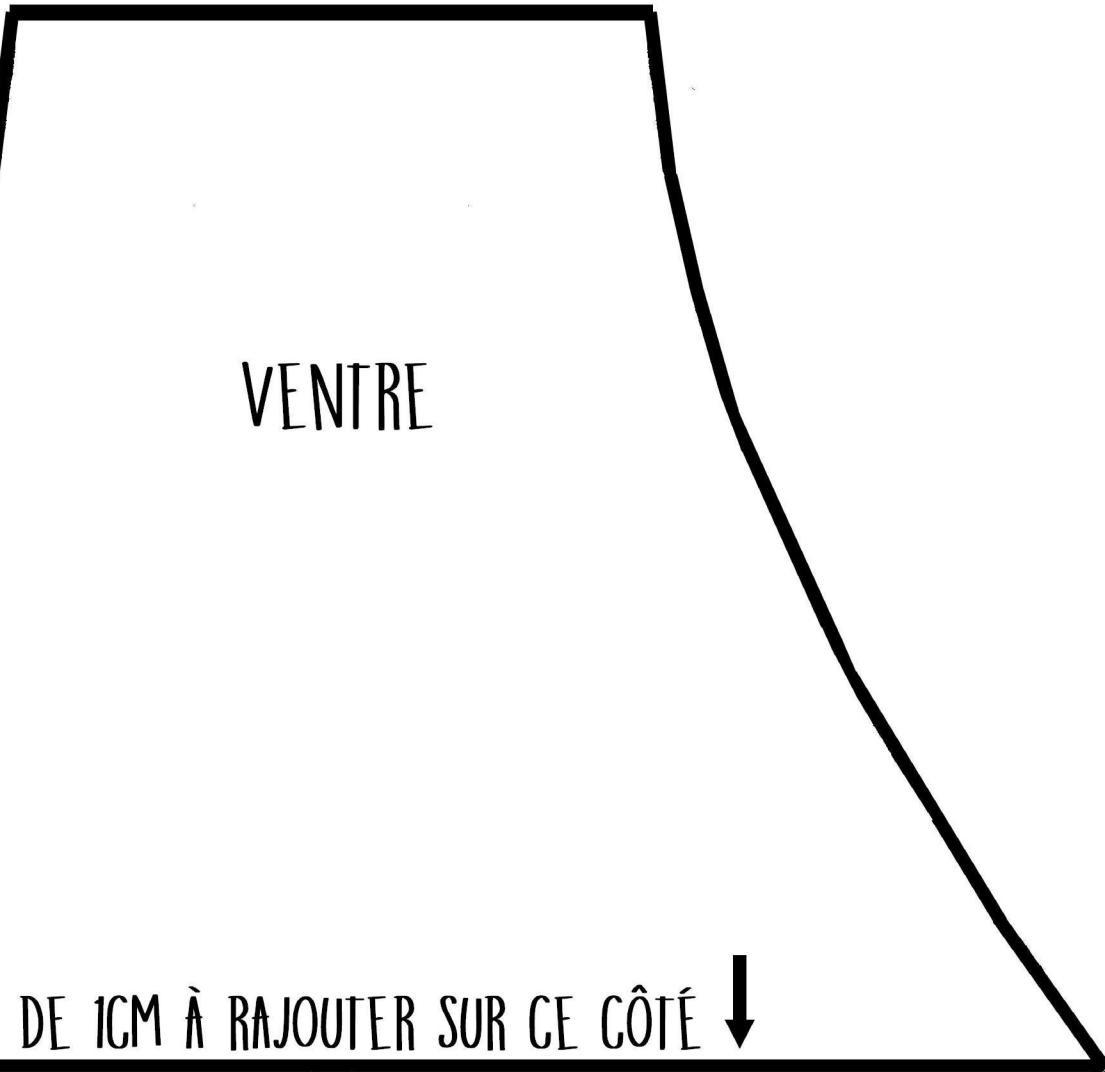

VENTRE

MARGE DE 1CM À RAJOUTER SUR CE CÔTÉ ↓